



## Implanon (applicering af)

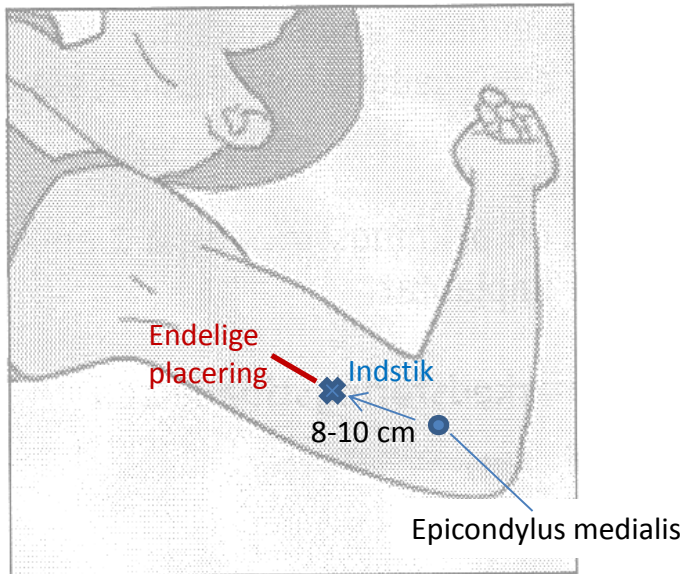

**Kontraindikation:**  
Allergi for estonogestrel  
DVT (ved disposition anbefales forsigtighed)  
Leversygdom  
Uforklarlig vag.blødning  
Hormonfølsom cancer

**Bivirkninger:**  
Vaginitis  
Hovedpine  
Akne  
Brystspænding  
Menoragi  
Vægtøgning





Fjern plastikbeskyttelsen over nålen . Den sidder fast så vrid den let fra side til side, til den er løs.



Puncture the skin with the tip of the needle angled at less than 30°

Perforer huden med højst 30 grader ift. huden



Lower the applicator to a horizontal position. While lifting the skin with the tip of the needle, slide the needle to its full length

Ret nu nålens retning, så den følger hudens overflade. Mens man fører nålen helt i bund, er det nyttigt samtidig at løfte lidt op i applikator og hud (så man er sikker på at holde sig højt i subcutis).



Hele nålen skal føres ind under huden.



While keeping the applicator in the same position and the needle inserted to its full length, unlock the purple slider by pushing it slightly down

Hold den grå applikator fast medens du fører det blå håndtag ned og tilbage



De blå håndtag skal helt tilbage, før du fjerner applikatoren. Huden kan "hænge" lidt i applikatoren, så den skal vristes forsigtigt af



Implanonen er ikke synlig, men skal kunne føles under huden.



Anlæg plaster og en lidt stram forbindelse. Sidstnævnte fjernes efter 4-6 timer.

Udarb. Af Lars Krag Møller, 2013  
Godkendt af afdelingens læger